contracepción-ginecología

euro gine

Catálogo general

thcare
TECNOLOGÍA
ACIÓN FAMILIAR dispositivos intrauterinos
salud ginecología
os intrauterinos
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
TECHNOLOGY healthcare
ine devices GYNECOLOGY

CONTRACEPCIÓN

Dispositivos intrauterinos

El Dispositivo Intrauterino ha sido determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la mejor opción para la regulación de la natalidad por su excelente relación EFECTIVIDAD-COSTE-INOCUIDAD.

Sus beneficios anticonceptivos son elevados en comparación con sus posibles efectos secundarios o desventajas, las cuales pueden reducirse considerablemente con una correcta elección de modelos y/o tamaños y con una correcta inserción, siempre atendiendo a los criterios de elegibilidad óptimos.

Asimismo, la anticoncepción de emergencia se puede lograr mediante la inserción de un DIU con cobre en los primeros cinco días después de una relación sexual desprotegida, según la Declaración de la Federación Internacional de Planificación Familiar sobre los Dispositivos Intrauterinos de 2003.

La gama de DIU's de Eurogine es la más diversa del mercado nacional e internacional, contando con una gran variedad de modelos, tamaños, cargas de cobre, núcleos de oro y plata en la espiral contraceptiva y sistemas de inserción.

GOLD T® (Cu375+Au)

Dispositivo Intrauterino con núcleo de oro en la espiral contraceptiva desarrollado por Eurogine en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) en 1999.

- Espiral contraceptiva de cobre de 99,9% de pureza con núcleo de oro de 0,1 mm. de diámetro que reduce su riesgo de rotura.
- DIU de alta carga: 375 mm^2 de superficie de cobre activa.
- Tiempo "in situ" recomendado: 5 años.
- 3 tamaños que permiten adaptarse a diferentes tamaños de útero aumentando el confort de la usuaria.
- Sistema de inserción fácil y único que provee de un alto grado de precisión en el emplazamiento del DIU.
- Riesgo de perforación nulo siguiendo las instrucciones de inserción correctamente.

Ref.	Descripción	Tamaño	Ancho	Largo	Ud. venta	CN
01040000	GOLD T® (Cu375+Au)	Maxi	36,5 mm.	38 mm.	Unidad	337798.0
01040100	GOLD T® (Cu375+Au)	Normal	31 mm.	33 mm.	Unidad	337794.2
01040200	GOLD T® (Cu375+Au)	Mini	24 mm.	30,5 mm.	Unidad	337793.5

Indique el C.N. en sus recetas médicas o la referencia y descripción completa incluido el tamaño

DIU's EN FORMA DE "ϒ"

Ref.	Descripción	Tamaño	Ancho	Largo	Núcleo plata	Ud. venta	CN
01010500	NOVAPLUS T 380 Ag (Cu380+Ag)	Normal	31 mm.	33 mm.	✓	Unidad	337797.3
01010600	NOVAPLUS T 380 Ag (Cu380+Ag)	Mini	24 mm.	30,5 mm.	✓	Unidad	337796.6
01010700	NOVAPLUS T 380 Ag (Cu380+Ag)	Maxi	36,5 mm.	38 mm.	✓	Unidad	337795.9
01020100	NOVAPLUS T 380 Cu (Cu380)	Normal	31 mm.	33 mm.		Unidad	337792.8
01020200	NOVAPLUS T 380 Cu (Cu380)	Mini	24 mm.	30,5 mm.		Unidad	337791.1

Indique el C.N. en sus recetas médicas o la referencia y descripción completa incluido el tamaño

DIU's EN FORMA DE ÁNCORA "Ω"

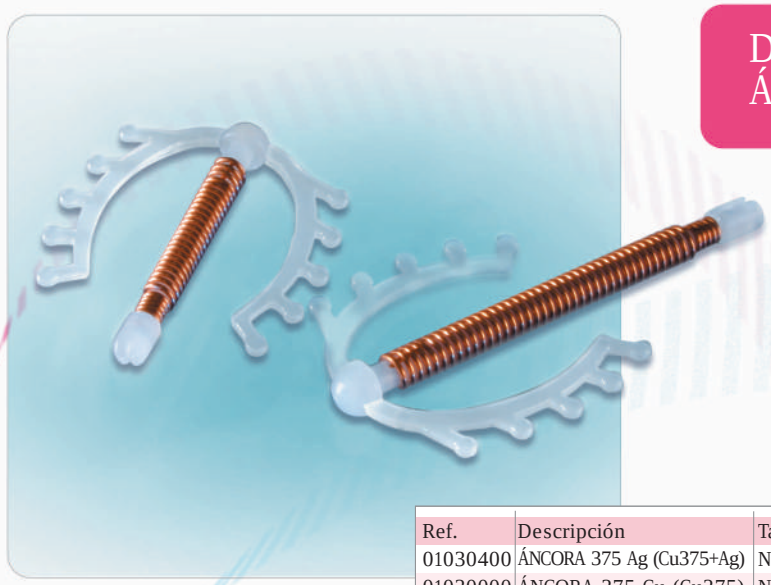

Ref.	Descripción	Tamaño	Ancho	Largo	Núcleo plata	Ud. venta	CN
01030400	ÁNCORA 375 Ag (Cu375+Ag)	Normal	20 mm.	35 mm.	✓	Unidad	156446.7
01030000	ÁNCORA 375 Cu (Cu375)	Normal	20 mm.	35 mm.		Unidad	337449.1
01030200	ÁNCORA 250 Cu	Mini	20 mm.	24 mm.		Unidad	

Indique el C.N. en sus recetas médicas o la referencia y descripción completa incluido el tamaño

PINZA EXTRACTORA DE DIU's

Ref. 19-720-20

Pinza de acero inoxidable para extraer DIU's y/o resituar hilos retraídos.

CONTRACEPCIÓN

Contracepción de barrera

DIAFRAGMAS DE SILICONA

Mejor colocación y adherencia por su sistema de plegado arciforme. Ausencia de alergias al látex. Presentado en estuche individual protector.

Ref.	Descripción	Ud. venta	CN
06030600	DIAFRAGMA SILICONA T/60	Unidad	155337.9
06030500	DIAFRAGMA SILICONA T/65	Unidad	337441.5
06030000	DIAFRAGMA SILICONA T/70	Unidad	337442.2
06030100	DIAFRAGMA SILICONA T/75	Unidad	337443.9
06030200	DIAFRAGMA SILICONA T/80	Unidad	337445.3
06030300	DIAFRAGMA SILICONA T/85	Unidad	337446.0
06030400	DIAFRAGMA SILICONA T/90	Unidad	337447.7

Indique el C.N. en sus recetas médicas o la referencia y descripción completa incluido el tamaño

ESTUCHE MEDIDORES DE DIAFRAGMA

Ref. 06031000

Caja con 5 medidores de silicona T/65-85. Las unidades del tallador pueden, tras su uso, esterilizarse en autoclave por vapor.

Venta unitaria.

MAQUETA PARA COLOCACIÓN DE DIAFRAGMA

Ref. 06032000

Modelo anatómico fabricado en un material muy suave y flexible que permite una correcta formación y entrenamiento para el aprendizaje en la colocación del diafragma.

Contracepción Quirúrgica

KIT DE VASECTOMÍA SIN BISTURÍ 3 PIEZAS

Ref. 18000000

La vasectomía es ampliamente utilizada como método de contracepción quirúrgica por su seguridad, coste y simplicidad como método de contracepción permanente para los hombres.
La Vasectomía Sin Bisturí (VSB) se desarrolló en China en 1974 y se introdujo en la comunidad médica occidental en 1985 en Nueva York, siendo en la actualidad recomendada como el mejor procedimiento por la Asociación Americana de Urología para la práctica de la vasectomía.
Desde entonces a más de 15 millones de hombres se les ha practicado la VSB en China.

La VSB ofrece ventajas importantes sobre el método tradicional con la misma efectividad:

- Produce menos hematomas, infecciones y complicaciones.
- No necesita puntos de sutura.
- Causa menor dolor y sangrado.
- Reduce el tiempo de intervención quirúrgica y consecuentemente los riesgos y los costes.

Los pacientes agradecen que:

- La cirugía no tenga puntos.
- La herida cierre espontáneamente en 72 horas.
- La inflamación y el dolor postoperatorios sean mínimos.

Los resultados han mostrado 10 veces menos hematomas, infecciones y otras complicaciones, un 0,4% para la VSB frente a un 3,1% para la vasectomía convencional.

El 80% de los médicos norteamericanos que practican VSB citan que sus pacientes experimentan mucho menos dolor y sangrado durante la cirugía. Asimismo comentan que, tras alguna práctica, la VSB puede realizarse un 50% más rápido que la vasectomía convencional.

Contiene

- 2 pinzas de sujeción extra cutánea de anillo con punta roma de 3,5 mm ø y 4,0 mm ø. Long. 140 mm.
- Pinza Mosquito muy afilada con la cara interna no serrada.

CÁNULAS DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA BERKELEY

- Excelente concentridad entre las paredes interior y exterior de la cánula (mínimo ø exterior y máximo ø interior).
- El ø de la cánula corresponde al número de semanas de embarazo.
- Cánula marcada con banda indicadora de la profundidad de inserción (10-12 cm).

CÁNULA BERKELEY RÍGIDA CURVA		
Ref.	Descripción	Ud. venta
16000618	CÁNULA BERKELEY RÍG. CV. ø 7 mm.	Unidad
16000611	CÁNULA BERKELEY RÍG. CV. ø 8 mm.	Unidad
16000612	CÁNULA BERKELEY RÍG. CV. ø 9 mm.	Unidad
16000613	CÁNULA BERKELEY RÍG. CV. ø 10 mm.	Unidad
16000614	CÁNULA BERKELEY RÍG. CV. ø 11 mm.	Unidad
16000615	CÁNULA BERKELEY RÍG. CV. ø 12 mm.	Unidad
16000616	CÁNULA BERKELEY RÍG. CV. ø 14 mm.	Unidad
16000617	CÁNULA BERKELEY RÍG. CV. ø 16 mm.	Unidad

CONTRACEPCIÓN

CÁNULA KARMAN BERKELEY		
Ref.	Descripción	Ud. venta
16000621	CÁNULA KARMAN BERKELEY ø 4 mm.	Unidad
16000622	CÁNULA KARMAN BERKELEY ø 5 mm.	Unidad
16000623	CÁNULA KARMAN BERKELEY ø 6 mm.	Unidad
16000624	CÁNULA KARMAN BERKELEY ø 7 mm.	Unidad
16000625	CÁNULA KARMAN BERKELEY ø 8 mm.	Unidad
16000626	CÁNULA KARMAN BERKELEY ø 10 mm.	Unidad

LEGRAS METÁLICAS RECAMIER

Legras metálicas Recamier maleables cortantes y romas, y legras metálicas Recamier rígidas cortantes y romas

DILATADORES CERVICALES

- Dilatadores cervicales Hegar del Nº 1 al Nº 31, y dilatadores cervicales Hegar del Nº 1,5 al Nº 19,5.
- Dilatadores cervicales Hegar dobles del 1/2 al 25/26 mm.
- Dilatadores cervicales Hawkin-Ambler del 3/6 al 22/25 mm.
- Dilatadores d'Alsace del Nº 10 al Nº 28.

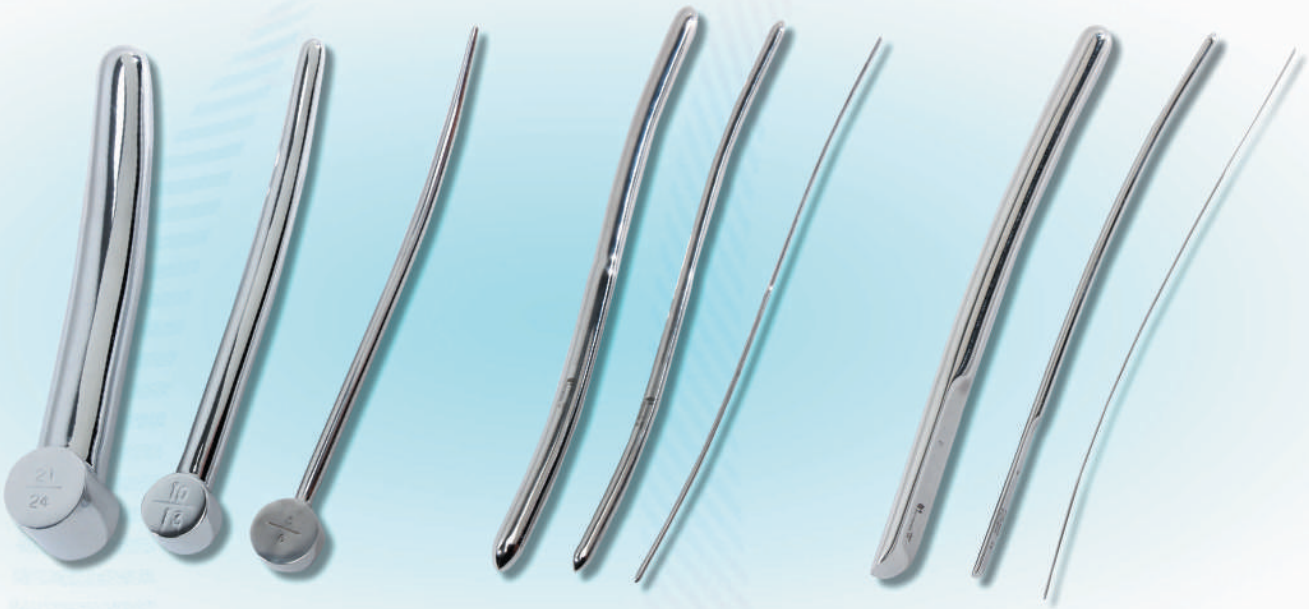

MODELOS ANATÓMICOS PARA FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

MODELO PARA PRESERVATIVO FEMENINO

Ref. 0607s509

- Tamaño real del útero en cavidad pélvica simulada.
- Diseñado para la colocación en el regazo simulando la posición en que el preservativo femenino debe insertarse.
- Permite la demostración de uso del preservativo femenino, la esponja contraceptiva y el capuchón cervical.
- Vulva y vagina de vinilo extra suave que permite flexibilidad y tacto realistas.

MODELO DE ENTRENAMIENTO PARA PRESERVATIVOS MASCULINOS

Ref. 06080000

Modelo anatómico realista fabricado en látex y sujeto a una base de metacrilato con una ventosa que permite su extracción para una fácil limpieza. En la base se reproducen las normas de uso del preservativo masculino, por lo que resulta una herramienta de formación muy útil.

MODELO ENTRENAMIENTO PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Ref. 0604s502

- Diseño de sobre escritorio para la demostración de la inserción y extracción del DIU, el diafragma y la esponja contraceptiva.
- Útero en ante versión con la cara superior claramente a la vista para la correcta posición del DIU, su inserción y extracción.
- Útero suspendido dentro de la cavidad uterina y movible para mostrar su posición normal, en ante versión y en retro versión.
- Cuello del útero con canal cervical.
- Vulva fabricada en vinilo extra suave que permite flexibilidad y tacto realistas.

MODELOS ANATÓMICOS PARA FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

MODELO ÚTERO

Ref. 0100s507

- Útero normal.
- Ventana de plástico transparente que permite una fácil visualización del correcto emplazamiento del DIU.
- Apto para distintos modelos de DIU.

MODELO ÓRGANOS PÉLVICOS FEMENINOS IV

Ref. 0604PF16

- Tamaño real.
- Dividido en dos partes, ilustrando las estructuras interna y externa de los órganos pélvicos femeninos.
- Sección extraíble de los genitales femeninos, la vejiga y el recto.

MODELO ÓRGANOS PÉLVICOS FEMENINOS I

Ref. 0100s506

- Sección coronal del útero, ovarios y trompas.
- Ventana de plástico transparente que permite una fácil visualización del correcto emplazamiento del DIU, su inserción y extracción.

MODELO GINECOLÓGICO GYN/AID

Ref. 0604s503

- Permite una experiencia gráfica del examen con espéculo vaginal, del examen pélvico bimanual, de las técnicas de inserción y extracción del DIU, del tamaño y posición del diafragma, de la histerometría y de la visualización del cérvix.
- Tamaño real de mujer adulta con órganos genitales anatómicamente exactos.
- Piel exterior suave y extraíble.
- Siete úteros con uno normal de control más seis con anomalías externas.
- Un útero transparente en ante versión.
- Dos cuellos de útero normales con canal uterino para la inserción y extracción del DIU.
- Seis cuellos de útero con anomalías cervicales.
- Útero y cérvix diseñados con un tornillo para su fácil y rápido cambio.
- Inserción y extracción de la esponja contraceptiva, el preservativo femenino, el diafragma y el capuchón cervical.

EXPLORACIÓN

Espéculos vaginales de un solo uso

Ventajas de los espéculos desechables:

- Sensación más confortable y agradable para la paciente.
- Sin riesgo de infecciones cruzadas.
- Listos para ser usados.
- Sin costes de mantenimiento, esterilización, personal, energético, etc.

¿Qué se espera de un espéculo desechable?

- Materiales médicamente adecuados.
- Envases adecuados e higiénicos.
- Sistemas de apertura y cierre garantizados.
- Alta calidad de fabricación y acabados.
- Gran campo de visión y trabajo.

EUROSPEC®

- Espéculo vaginal desechable, de un solo uso. Acabados, transparencia, articulaciones y prestaciones de gran calidad.
- Diseño moderno, funcional y ergonómico.
- Gran tamaño del campo visual y de trabajo en cualquiera de sus 4 tamaños de valvas: Grande, Mediano, Pequeño y Virginal.
- Dos sistemas de sujeción: Tornillo rápido y silencioso y Corredera silenciosa.

EUROSPEC® DE CORREDERA

Ref.	Descripción	Ud. venta
02082100	EUROSPEC® CORREDERA GRANDE	Caja 100 u.
02082200	EUROSPEC® CORREDERA MEDIANO	Caja 100 u.
02082300	EUROSPEC® CORREDERA PEQUEÑO	Caja 100 u.
02082400	EUROSPEC® CORREDERA VIRGINAL	Caja 100 u.

EUROSPEC® DE TORNILLO

Ref.	Descripción	Ud. venta
02081100	EUROSPEC® TORNILLO GRANDE	Caja 100 u.
02081200	EUROSPEC® TORNILLO MEDIANO	Caja 100 u.
02081300	EUROSPEC® TORNILLO PEQUEÑO	Caja 100 u.
02081400	EUROSPEC® TORNILLO VIRGINAL	Caja 100 u.

EXPLORACIÓN

ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL

- Espéculo vaginal graduable estéril para la dilatación de la vagina y la exposición del cuello del útero, con un gran campo de visión y trabajo.
- Superficie lisa y bordes redondeados para una inserción confortable.
- Cierre con lengüeta central que puede doblarse para una mejor utilitzación del instrumental.
- Empuñadura ergonómica para un agarre seguro durante su manipulación

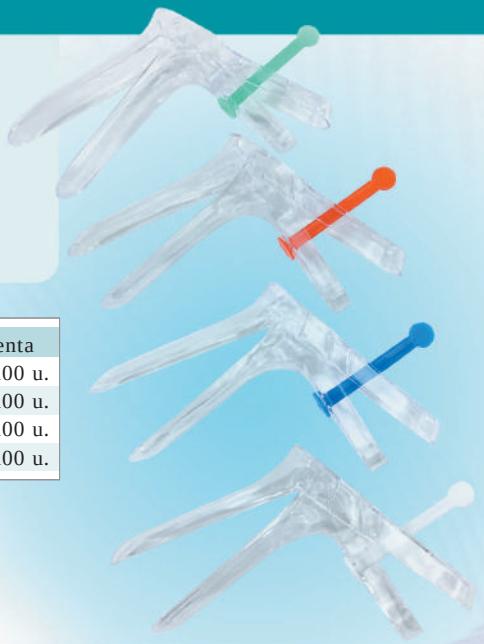

Ref.	Descripción	Ud. venta
02090100	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL GRANDE	Caja 100 u.
02090200	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL MEDIANO	Caja 100 u.
02090300	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL PEQUEÑO	Caja 100 u.
02090400	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL VIRGINAL	Caja 100 u.

ESPÉCULO VAGINAL MIXTO GYNESPEC®

- Espéculo vaginal mixto: mango reutilizable y valvas de un solo uso. Acabados, transparencia, articulaciones y prestaciones de gran calidad.
- El mango puede lavarse, desinfectarse o esterilizarse en frío o en autoclave de ser necesario.
- Diseño moderno, funcional y ergonómico.
- Gran campo visual y de trabajo en cualquiera de sus 4 tamaños de valvas: Grande, Mediano, Pequeño y Virginal.
- Fácil y seguro de montar ya que cualquier tamaño de valva encaja perfectamente con el mango, pues en el extremo del montaje todos los tamaños son iguales.
- Sistema de sujeción mediante Corredera silenciosa.
- Diseñado para reducir el volumen de almacenaje y de desecho en un 70%, por lo que resulta ideal para aquellas consultas con escaso espacio de almacenaje.

Ref.	Descripción	Ud. venta
02050000	GYNESPEC® GRANDE	Caja 250
02050100	GYNESPEC® MEDIANO	juegos de valvas
02050200	GYNESPEC® PEQUEÑO	+ 3 mangos
02050300	GYNESPEC® VIRGINAL	
02050400	MANGO PARA GYNESPEC®	Caja 6 u.

Comparación real de volúmenes de almacenaje

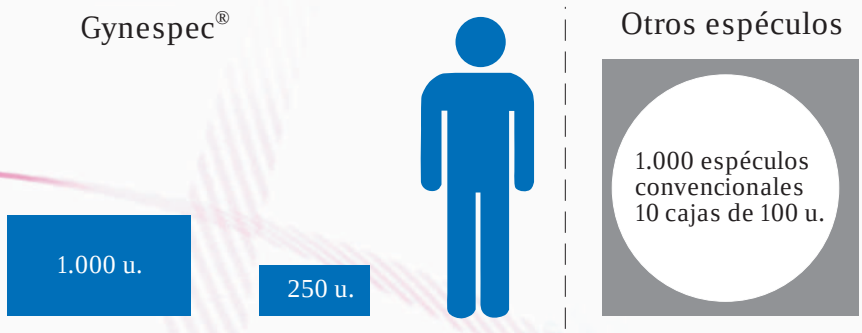

Ecografía

GEL TRANSMISOR EUROGINE 500 ml.

Ref. 05010100

- Para diagnóstico y terapia con ultrasonidos.
- Ligeramente azulado, con extractos de pepino con propiedades astringentes, emolientes y calmantes. Refrescante y descongestivo.
- No contiene perfume.
- No irrita la piel ni los tejidos.
- No deteriora el transductor.
- Soluble en agua y alcohol etílico; no engrasa.
- Gel de primerísima calidad, presentado en botellas invertidas y anatómicas para su máximo aprovechamiento sin incómodas maniobras de trasvase y sin necesidad de sacudidas para su extracción total.
- Caja 8 u.

FUNDAS PROTECTORAS PARA SONDA ECOGRÁFICA

LÁTEX FREE

Ref.	Descripción	Ud. venta
05050000	FUNDA SONDA ECOG. POLIETILENO “Vagi-Cover”	Caja 100 u.
05050100	FUNDA SONDA ECOG. ESTÉRIL EVA “Stericover”	Caja 50 u.

CONTIENEN LÁTEX

Ref.	Descripción	Ud. venta
05030000	FUNDA SONDA ECOGRÁFICA ESTÉRIL. Envase unitario	Caja 100 u.
05020300	FUNDA SONDA ECOGRÁFICA. N/e. Foil.	Caja 500 u.
05020200	FUNDA SONDA ECOGRÁFICA. N/e. Foil. 4 cajas de 500 u.	Caja 2.000 u.

PAPEL PARA VÍDEOIMPRESORA

Ref.	Descripción	Ud. venta
11400000	ROLLO SONY UPP110S. Densidad normal.	Caja 10 u.
11400200	ROLLO SONY UPP110HA. Alta densidad.	Caja 10 u.
1100K61B	ROLLO MITSUBISHI K61B. Densidad normal.	Caja 4 u.
11K65-HM	ROLLO MITSUBISHI K65-HM. Alta densidad.	Caja 4 u.

EXPLORACIÓN

Instrumental desechable

HISTERÓMETRO

Ref. 04020000

Telescópico de lectura externa para medir la profundidad del útero (ø 3,5mm.). Estéril. De un solo uso.
Caja 25 u.

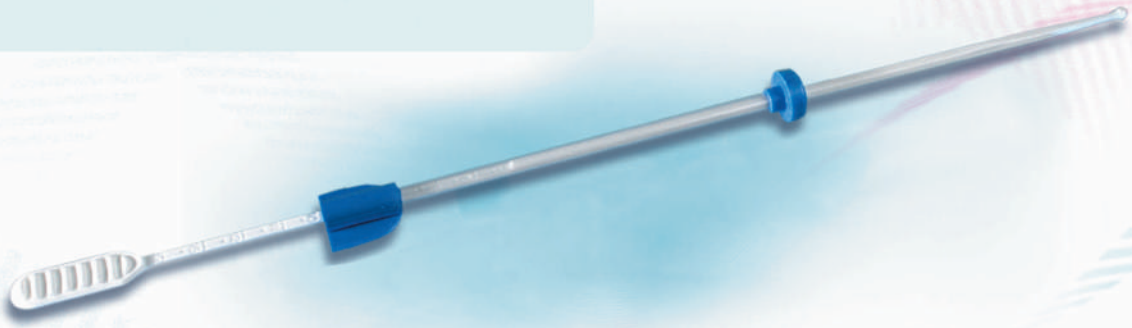

PINZA DE CUELLO UTERINO

Ref. 04030000

Pinza tipo Pozzi guiada y con sistema de anclaje para asegurar el cierre para la tracción del cuello uterino. Estéril. De un solo uso.
Caja 25 u.

INSTRUMENTAL METÁLICO

Con 5 años de garantía.

DIAGNÓSTICO

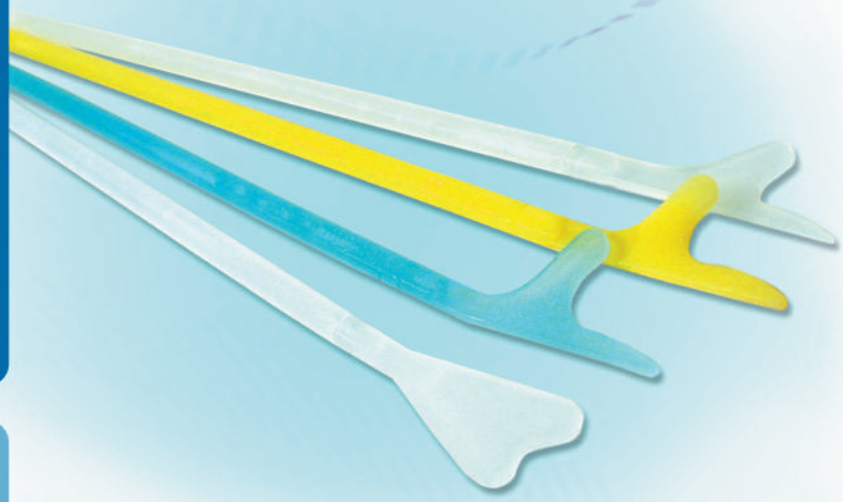

Test de Papanicolau

CYTO-SPATULA SZALAY

¡Basta un instrumento, un frotis para obtener suficientes células representativas de todas las zonas!
Una buena prevención es el mejor remedio.
Ahora el Test de Papanicolau con un solo instrumento, ahorrando tiempo y dinero.
La Cyto-Spatula Szalay es el instrumento óptimo para la prevención citológica contra el cáncer cervical.
Para una valoración citológica segura se precisa en primer lugar un material celular suficientemente representativo y bien conservado. Todos los pasos analíticos ulteriores dependen de este requerimiento. Por ello, los Dres. L. Szalay y J. Jenny desarrollaron esta espátula en Suiza, llevando más de 20 años en el mercado, dando siempre excelentes resultados y beneficiando sobre todo a las mujeres y a su salud.

Causas más frecuentes de falsos negativos

- Cantidad extraída de material citológico insuficiente (utilizando un hisopo, aproximadamente el 30% de las extracciones resultan insuficientes).
- Diagnóstico negativo del caso positivo debido a un material inapropiado.
- La neoplasia intraepitelial es en un 15-20% de los casos de origen endocervical. Esto significa que no es posible detectar la misma con antelación ni con el colposcopio ni con los métodos clásicos de obtención de material.
- En un porcentaje significativo de los casos de displasia aguda, carcinoma in situ y carcinoma invasivo, la zona de cornificación de Dierk presenta una capa gruesa hiperqueratósica que evita la exfoliación espontánea de las células tumorales que se encuentran en las capas más profundas, lo cual imposibilita la obtención de células tumorales en muchos casos.
- Las alteraciones del riego sanguíneo y del metabolismo causan degeneración y necrosis. Esta capa de necrosis evita la obtención de células de las zonas inferiores al carcinoma. Esto explica el 20-25% de los casos de diagnóstico negativo falso al presentarse carcinomas invasivos.

VENTAJAS de la Cyto-Spatula Szalay:

- Un solo frotis permite obtener suficiente material celular representativo de todas las zonas del cuello uterino.
- La superficie de la Cyto-Spatula Szalay de diseño especial causa una exfoliación provocada resultando en una extracción también de las células de las capas celulares más profundas, allí donde con frecuencia se generan los tumores.
- Hoy en día, el 20% de todos los carcinomas cervicales se generan en la endocervical. Por ello es absolutamente necesario la obtención de suficiente material endocervical.
- Para diferentes formas y tamaños de cuellos uterinos, se han desarrollado 4 modelos de Cyto-Spatula Szalay que permiten la extracción de material aún tratándose de canales cervicales muy estrechos o casi cerrados.
- Si se realiza el frotis correctamente, las células se ordenan sobre el portaobjetos en una única capa (Monolayer) y su estructura relacionada se conserva.
- El diseño especial de la Cyto-Spatula Szalay permite extender suficiente material celular representativo sobre el portaobjetos.
- El análisis de un frotis convencional con la Cyto-Spatula Szalay es seguro, rápido y resulta mucho más económico. Además, en comparación con otros métodos, genera menos desechos.
- Permite obtener resultados altamente fiables, tanto si se emplean métodos de análisis convencionales como los más modernos “Liquid Based”.
- Su cabezal tiene un punto de rotura controlado que permite deponerlo en un recipiente apropiado para su posterior análisis mediante “Liquid Based”.
- La Cyto-Spatula Szalay ha sido probada millones de veces y es de muy fácil manejo.
- Si el frotis se realiza siguiendo las instrucciones correctamente es totalmente indoloro para la paciente.

Cyto-Spatula Szalay

Foto	Ref.	Descripción	Ud. venta
	07060000	Cyto-Spatula Szalay Blanca Nº1. Apropiada para cuellos uterinos de pequeño a mediano tamaño (la mayoría de los casos).	Bolsa 100 u
	07060100	Cyto-Spatula Szalay Amarilla Nº2. Apropiada para cuellos uterinos de gran tamaño y orificio uterino ancho.	Bolsa 100 u
	07060200	Cyto-Spatula Szalay Azul Nº3. Apropiada para cuellos uterinos muy grandes y canal vaginal ancho.	Bolsa 100 u
	07060300	Cyto-Spatula Szalay Nº4. Apropiada para cuellos uterinos muy grumosos y zonas de transformación dilatadas, adicionalmente a las Cyto-Spatula Szalay Nº 1, 2 ó 3. Apropiada para canales cervicales obliterados o muy estrechos, inacesibles para la Cyto-Spatula Szalay Nº1, y sólo para la superfície del cuello uterino con la correspondiente advertencia al laboratorio citológico. Apropiada en combinación con un citocepillo.	Bolsa 100 u

Todos los modelos tienen una longitud de 220 mm

Szalay Cyto-Spatula Manufacturer

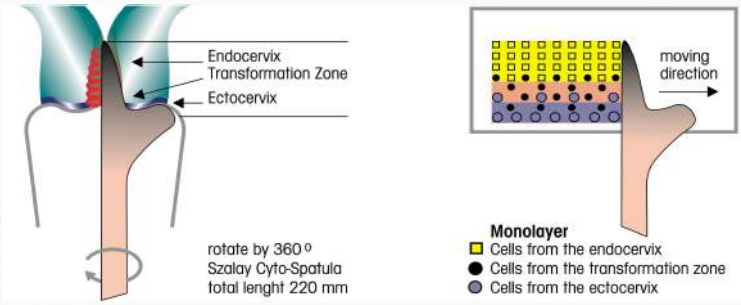

Toma de muestras endometriales

GINEASPIR®

Ref. 03010000

Equipo totalmente desechable para la obtención de muestras del endometrio para su diagnóstico histo-citológico utilizando la técnica del legrado en combinación con la aspiración. Estéril. De un solo uso. Caja 25 u.

Contiene

- 1 cánula de aspiración Karman del nº 4 con adaptador para la jeringa.
- 1 jeringa de aspiración, con cono Luer, de 20 cc. con freno.
- 1 tubo de 12 ml. para recogida de muestra con etiqueta identificativa.

Modo de empleo

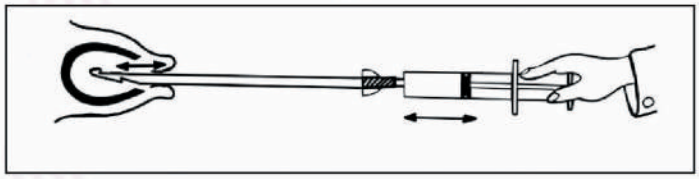

BIASPIR

Ref. 03020000

Equipo totalmente desechable para la obtención de muestras de endometrio para el procesamiento histo-citológico de la mucosa endometrial por doble aspiración (Método DABE – Doble Aspiración para Biopsia Endometrial).
El Método DABE consiste en la combinación de la aspiración que ejerce la jeringa, con los movimientos de rotación y ascenso-descenso que se aplica a los catéteres una vez introducidos en el útero empleándolos sucesivamente.
Estéril. De un solo uso. Caja 25 u.

Contiene

- 1 catéter flexible de 2 mm. de Ø con múltiples orificios para aspiración en su extremo distal con conector en el extremo proximal para acoplarlo a la jeringa.
- 1 catéter flexible de 3 mm. de Ø con múltiples orificios para aspiración en su extremo distal con conector en el extremo proximal para acoplarlo a la jeringa.
- 1 jeringa de aspiración, con cono Luer, de 20 cc. con freno.
- 1 tubo de 12 ml. para recogida de muestra con etiqueta identificativa.

Modo de empleo

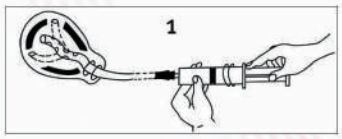

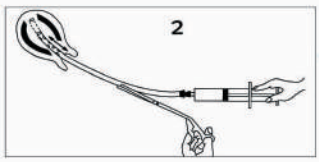

CYTOSPAT®

Ref. 03030000

Equipo totalmente desechable para la obtención de muestras de endometrio para su diagnóstico histo-citológico, combinando el curetaje y la aspiración, concebido para que se realice fácilmente a nivel de consulta o ambulatorio. Estéril. De un solo uso. Caja 25 u.

Las ventajas de CYTOSPAT® son

- Fácil manejo: su diseño sencillo hace de CYTOSPAT® una herramienta de fácil utilización.
- Totalmente desechable.
- Su especial diseño asegura la fiabilidad de la muestra, no existiendo la posibilidad de contaminación por tejido cervical.
- La combinación de curetaje y aspirado garantiza la cantidad suficiente de muestra para realizar un buen diagnóstico histo-citológico.
- Es ideal para la consulta privada o ambulatoria: la inocuidad, facilidad de manejo, su bajo coste y el no requerir anestesia ni hospitalización, hacen de CYTOSPAT® el equipo ideal para el diagnóstico histo-citológico de endometrio.

Contiene

- 1 cureta cuadrilateral de bordes cortantes y terminación redondeada unida a una varilla impulsora con empuñadura.
- 1 cánula insertadora con tope deslizante.
- 1 jeringa de aspiración, con cono Luer, de 20 cc. con freno, 1 adaptador/conector para jeringa y 1 tubo de 12 ml. para recogida de muestra con etiqueta identificativa.

Modo de empleo

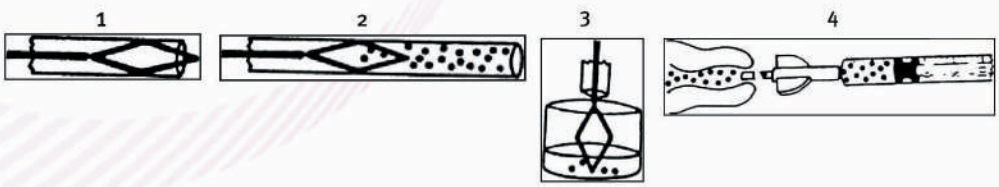

Citología

CITOCEPILLOS Y ESPÁTULAS DE AYRE

Citocepillo endocervical estéril

Ref. 07020000

Cepillo cónico para la recolección de muestra cervical por barrido y extracción. Estéril. De un solo uso. Caja 100 u.

Citocepillo endocervical

Ref. 07010000

Cepillo cónico para la recolección de muestra cervical por barrido y extracción. De un solo uso. Caja 100 u. en bolsas de 10 u.

Ref. 07010100

Cepillo cónico para la recolección de muestra cervical por barrido y extracción. De un solo uso. Caja 500 u. en bolsas de 10 u.

Espátula de Ayre

Ref. 11010000

De madera. Recoleción de muestras vaginales para citología. Bordes atraumáticos. De un solo uso. Caja 500 u.

Espátula de Ayre estéril

Ref. 11010100

De madera. Envase individual. Recolección de muestras vaginales para citología. Bordes atraumáticos. Estéril. De un solo uso. Caja 100 u.

CITOKITS

Citokit con hisopo

Ref. 07040000

Equipo para la toma y transporte de muestras para citología cérvico-vaginal. De un solo uso. Caja 100 u.
Contiene: Estuche para datos identificativos / Hisopo / Espátula de Ayre / Frasco de fijador citológico Cytofix / Portaobjetos con banda mate.

Citokit con cepillo estéril

Ref. 07050000

Equipo para la toma y transporte de muestras para citología cérvico-vaginal. Estéril. De un solo uso. Caja 100 u.
Contiene: Estuche para datos identificativos / Citocepillo/ Espátula de Ayre / Frasco de fijador citológico Cytofix / Portaobjetos con banda mate.

Citokit con cepillo

Ref. 07050100

Equipo para la toma y transporte de muestras para citología cérvico-vaginal. De un solo uso. Caja 100 u.
Contiene: Estuche para datos identificativos / Citocepillo/ Espátula de Ayre / Frasco fijador citólogico Cytofix / Portaobjetos con banda mate.

DIAGNÓSTICO

CYTOFIX

Ref. 11060000

Fijador hidrosoluble para citología exfoliativa. Fija y preserva las muestras con rapidez y seguridad sin alterar sus propiedades biológicas. Envase de 75 ml.
Caja 16 u.

Otros

OTROS		
Ref.	Descripción	Ud. venta
11100300	PORTAOBJETOS CON BANDA MATE	Caja 50 u.
11100200	PORTAOBJETOS CON CANTO PULIDO. Sin banda mate.	Caja 50 u.
11030000	HISOPO-TORUNDA. Con mango de madera.	Caja 500 u.
v201010	GASA COMPRESA 20 x 20 GRANEL	Caja 3.000 u.
11070100	MAQUINILLA DE RASURAR CON 2 CUCHILLAS	Caja 1.000 u.

PISTOLA DE PUNCIÓN PARA BIOPSIAS

Ref. 11500000

Pistola de Punción para biopsias que permite la utilización de jeringas de 10 cc. y 20 cc., aprovechando entre el 75% y el 90% de la capacidad de aspiración de las mismas. Fácil manejo con una sola mano. Ambidextra.
Venta unitaria.

KIT BÁSICO PARA AMNIOCENTESIS Y CORION

Ref. 03050200
Estéril. De un solo uso. Caja 12 u.
Contiene:

- 1 cánula con llave y conector para acoplarla a la jeringa.
- 1 jeringa para aspiración de 2o cc. de 2 cuerpos y con freno.

KIT PARA AMNIOCENTESIS Y CORION

Ref. 03050000
Estéril. De un solo uso. Caja 10 u.
Contiene:

- 1 jeringa de 2 mm. para primera extracción.
- 1 aguja 20G 3 1/2.
- 1 jeringa para aspiración de 20 cc. de 2 cuerpos y con freno.
- 1 talla de 75 x 100 cm.
- 1 cubre pacientes de 80 x 100 cm.
- 3 gasas de malla.
- 3 torundas de gasa.
- 1 par de guantes de látex T/med.
- 1 funda de plástico.
- 1 cánula con llave y conector para acoplarla a la jeringa.

SET CATÉTER GLÁNDULA BARTHOLIN

Ref. 16003000
Set para el tratamiento de abcesos de la Glándula de Bartolino. De un solo uso. Caja 6 u.

DILATADORES VAGINALES TERAPÉUTICOS DONEA®

Ref. 11260200
Set de dilatadores vaginales progresivos para el tratamiento del Vaginismo y la Dispareunia; para cirugía vaginal reconstructiva, y tras tratamiento con radiación.

PROTECCIÓN E HIGIENE

BATAS TIPO CAMISÓN PARA PACIENTE

Diseño exclusivo Eurogine.
Cómodo diseño para exploración gineco-mamaria.
Baja transparencia (gramaje de 40 gr.)

Ref. 09070700
Bata tipo camisón blanca. En bolsa unitaria.
Caja de 100 u.

Ref. 09070800
Bata tipo camisón azul. En bolsa unitaria.
Caja de 100 u.

SABANILLAS Y TALLAS

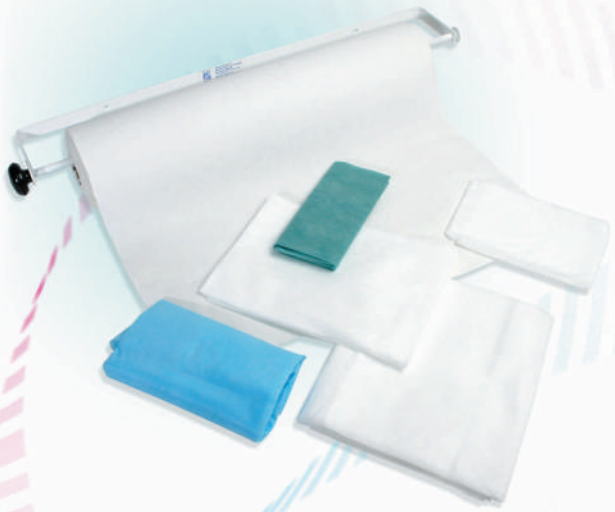

Ref.	Descripción	Ud. venta
09030100	CUBRE CAMILLAS BLANCO 80 x 200 cm.	Caja 100 u.
09040000	CUBRE PACIENTES BLANCO 80 x 100 cm.	Caja 100 u.
09040100	CUBRE PACIENTES BLANCO 80 x 50 cm.	Caja 500 u.
09050000	CUBRE SILLÓN GINECOL. BLANCO 80 x 160 cm.	Caja 100 u.
09060000	ASIENTO POSADERA 40 x 50 cm.	Caja 500 u.
VX14035	TALLA PLASTIFICADA ESTÉRIL 40 x 45 cm.	Caja 500 u.
VX14035GR	TALLA PLASTIFICADA N/ESTÉRIL 40 x 45 cm.	Caja 1.100 u.
VX14053	TALLA PLASTIFICADA ESTÉRIL 50 x 75 cm.	Caja 350 u.
VX14052	TALLA PLASTIFICADA N/ESTÉRIL 50 x 75 cm.	Caja 600 u.
VX14076TEN	TALLA PLASTIFICADA ESTÉRIL 75 x 100 cm.	Caja 175 u.
VX14075TGN	TALLA PLASTIFICADA N/ESTÉRIL 75 x 100 cm.	Caja 300 u.

CUBRE ZAPATOS Y ZAPATILLAS

Ref.	Descripción	Ud. venta
11070200	CUBRE ZAPATOS TST 30 gr. SUJ. ELÁST.	Caja 1.000 u.
11070000	CUBRE ZAPATOS PLÁSTICO SUJ. ELÁST.	Caja 2.000 u.
LC574	ZAPATILLAS CERRADAS TST PP	Caja 250 pares

GUANTES

Consúltenos sobre:
Guantes de látex con y sin polvo.
Guantes de vinilo con y sin polvo.
Guantes sintéticos reforzados.
Guantes de nitrilo.

Ref.	Descripción	Ud. venta
11090000	GUANTES DE PLÁSTICO TACTO NO ESTÉRIL	Caja 1.000 u.
11090100	GUANTES DE PLÁSTICO TACTO NO ESTÉRIL	Caja 10.000 u.
11091000	GUANTES DE PLÁSTICO TACTO ESTÉRIL	Caja 3.000 u.

OTROS

OTROS		
Ref.	Descripción	Ud. venta
LC522-2	ROLLO SECAMANOS BICAPA 0,22 x 180 m. Precortado a 40 cm.	Caja 6 u.
LC796	DISPENSADOR PAPEL SECAMANOS GRANDE	Unidad
LC552-2	ROLLO MINI SECAMANOS BICAPA 0,20 x 100 m.	Caja 20 u.
LC786	DISPENSADOR PAPEL SECAMANOS PEQUEÑO	Unidad
LC9502	ROLLO CELULOSA INDUSTRIAL BICAPA 0,25 x 500 m. Precortado a 40 cm.	Unidad
LC518	TOALLITAS BICAPA ZIG-ZAG 24 x 23 cm. Paquete 200 u.	Caja 20 paq.
LC772	DISPENSADOR TOALLITAS ZIG-ZAG SATINADO	Unidad
LC770-P	DISPENSADOR TOALLITAS ZIG-ZAG BLANCO	Unidad
LC121-R	ROLLO CAMILLA TST PP 0,58 x 80 m. Precortado a 40 cm.	Caja 6 u.
11220300	SOPORTE ROLLO CAMILLA MODELO EUROSTAR	Unidad

ESTERILIZACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Esterilización

BOBINA MIXTA VIEWPACK CON FUELLE

Indicador de vapor, OE y formaldehído

Ref.	Descripción	Ud. venta
300077	BOBINA MIXTA VIEWPACK CON FUELLE 100 mm x 40 mm x 100 m.	Unidad
300078	BOBINA MIXTA VIEWPACK CON FUELLE 150 mm x 50 mm x 100 m.	Unidad
300079	BOBINA MIXTA VIEWPACK CON FUELLE 200 mm x 50 mm x 100 m.	Unidad
300080	BOBINA MIXTA VIEWPACK CON FUELLE 250 mm x 60 mm x 100 m.	Unidad
300081	BOBINA MIXTA VIEWPACK CON FUELLE 300 mm x 60 mm x 100 m.	Unidad

BOBINA MIXTA VIEWPACK PLANA

Indicador de vapor, OE y formaldehído

Ref.	Descripción	Ud. venta
310838	BOBINA MIXTA VIEWPACK PLANA 50 mm x 200 m.	Unidad
300085	BOBINA MIXTA VIEWPACK PLANA 75 mm x 200 m.	Unidad
300086	BOBINA MIXTA VIEWPACK PLANA 100 mm x 200 m.	Unidad
300087	BOBINA MIXTA VIEWPACK PLANA 120 mm x 200 m.	Unidad
300088	BOBINA MIXTA VIEWPACK PLANA 150 mm x 200 m.	Unidad
300089	BOBINA MIXTA VIEWPACK PLANA 210 mm x 200 m.	Unidad
300090	BOBINA MIXTA VIEWPACK PLANA 250 mm x 200 m.	Unidad
300091	BOBINA MIXTA VIEWPACK PLANA 300 mm x 200 m.	Unidad
300092	BOBINA MIXTA VIEWPACK PLANA 400 mm x 200 m.	Unidad

BOBINA MIXTA VIEWPACK AUTOADHESIVA

Indicador de vapor y OE

Ref.	Descripción	Ud. venta
311249	BOLSA MIXTA VIEWPACK AUTOADHESIVA 90 x 203 mm.	Caja 200 u.
311250	BOLSA MIXTA VIEWPACK AUTOADHESIVA 90 x 230 mm.	Caja 200 u.
311251	BOLSA MIXTA VIEWPACK AUTOADHESIVA 90 x 560 mm.	Caja 200 u.
311253	BOLSA MIXTA VIEWPACK AUTOADHESIVA 130 x 254 mm.	Caja 200 u.
311254/A	BOLSA MIXTA VIEWPACK AUTOADHESIVA 130 x 356 mm.	Caja 200 u.
311255	BOLSA MIXTA VIEWPACK AUTOADHESIVA 140 x 285 mm.	Caja 200 u.
311256	BOLSA MIXTA VIEWPACK AUTOADHESIVA 200 x 330 mm.	Caja 200 u.
311258	BOLSA MIXTA VIEWPACK AUTOADHESIVA 300 x 390 mm.	Caja 200 u.
311259	BOLSA MIXTA VIEWPACK AUTOADHESIVA 300 x 450 mm.	Caja 200 u.

Autoclaves

ESTERILIZADOR A VAPOR MATACHANA 21 E

Características:

- Esterilizador conforme a la Directiva de Producto Sanitario, como esterilizador menor de 1 módulo de esterilización.
- Autónomo (no precisa conexión de agua ni desagüe).
- Depósito de agua con nivel para llenado de cámara.
- Sistema de seguridad de cierre y apertura de puerta.
- Cámara de una sola pieza, sin soldaduras.
- Electroválvula de equilibrio de presión para la apertura.
- Empuñadura de cierre ergonómica en material anticalórico.
- Puerta aislada térmicamente.
- Junta de puerta muy eficaz y fácil de limpiar.
- Eliminación del aire al inicio por purgador automático.

Programas:

- Instrumental a 134ºC
- Cauchos a 121ºC

ESTERILIZADOR A VAPOR MATACHANA 21 ED

Características:

- Tres tipos de ciclo en un sólo esterilizador: ciclos tipo N, S, y B. Con las máximas exigencias de seguridad y funcionamiento para pequeños esterilizadores de vapor (norma europea EN 13060:2004).
- Control por microprocesador.
- Condensador más bomba de vacío para la extracción del aire.
- Cámara de una sola pieza, sin soldaduras .

Programas:

- Flash – N 134º C Instrumental sin embalar hasta 2 Kg.
- Rapid – S 134º C Instrumentos de estructura simple, embalados hasta 2 kg / y sin embalar hasta 4 kg.
- Estándar – B 134º C Instrumentos complejos y textil, embalados hasta 2 kg / sin embalar hasta 4 kg.
- Estándar – B 121º C Instrumentos complejos no aptos para 134º C y textil, embalados hasta 2 kg / sin embalar hasta 4 kg.
- Especial – B 134º C Tratamiento especial instrumentos complejos y textil, embalados hasta 2 kg / sin embalar hasta 4 kg.
- Test de penetración Test Helix.
- Test de vacío Cámara vacía.

Otros

Ref.	Descripción	Ud. venta
104/381	CINTA INDICADORA VAPOR 19 mm x 50 m.	Unidad
254000001	PAPEL CREPADO VERDE 50 x 50	Caja 500 u.
302642	TIRAS DE CONTROL VIEW-TEST VAPOR. Tiras dobles.	Caja 250 u.
85683	TIRAS DE CONTROL TST VALISAFE VAPOR	Caja 250 u.
85696	CONTROL BIOLÓGICO BIONOVA	Caja 100 u.

Limpieza, desinfección y esterilización

Productos de limpieza y desinfección para superficies, equipos médicos, mobiliario y esterilización de instrumental.

Ref.	Descripción	Ud. venta
IE-2554	INSTRUNET FA CONCENTRADO. Envase de 1.000 ml.	Unidad
IE-30	INSTRUNET ESPORICIDA. Envase de 1.300 ml.	Unidad
IE-2934	INSTRUNET ANIOSURF CITRON. Garrafa de 5 L.	Unidad
IE-72	INSTRUNET EN POLVO	Caja 100 u.
IE-74	INSTRUNET GLUTARALDEHÍDO 2%	Unidad
IE-79	INSTRUNET ESPORICIDA. Envase 350 ml.	Unidad
IE-80	INSTRUNET LÍQUIDO MONODOSIS. Sobre 50 ml.	Caja 100 u.
IE-81	INSTRUNET DESINFECTANTE SPRAY. Envase 450 ml.	Unidad
IE-EZ	INSTRUNET ENZIMÁTICO. Envase 1.000 ml.	Unidad

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Esta sección es una muestra de mobiliario y equipamiento médico. Solicítenos presupuesto sin compromiso; le asesoraremos según sus necesidades.

Mesas para exploración ginecológica

MESAS MANUALES PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

Mod. G-10P
- Longitud: 1.750 mm.
- Ancho: 600 mm.
- Alto: 800 mm.

Mod. M-84G
- Longitud: 1.780 mm.
- Ancho sin guías: 520 mm.
- Alto: 800 mm.
- Inclinación respaldo: 60º

Mod. M-84GT
- Longitud: 1.750 mm.
- Ancho sin guías: 600 mm.
- Alto: 800 mm.
- Inclinación respaldo: 75º
- Posición Trendelemburg: 20º

MESAS ELÉCTRICAS PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

Mod. GT-15P

Mesa de exploración ginecológica de tres secciones elevable en altura por motor eléctrico con mando manual. Trendelemburg, respaldo y piecero accionados mediante pistón a gas.

- Longitud: 1.750 mm.
- Ancho: 600 mm.
- Altura máx.: 1.000 mm.
- Altura mín.: 700 mm.

Mod. M-89G

- Longitud: 1.750 mm.
- Altura máx.: 1.005 mm.
- Altura mín.: 715 mm.
- Ancho sin guías: 600 mm.
- Conexión a red: 220 V 80 W
- Inclinación respaldo: 75º
- Altura regulable por motor eléctrico.

Mod. M-89GT

- Longitud: 1.750 mm.
- Altura máx.: 1.005 mm.
- Altura mín.: 715 mm.
- Ancho sin guías: 600 mm.
- Conexión a red: 220 V 80 W
- Inclinación respaldo: 75º
- Posición Trendelemburg: 20º
- Altura regulable por motor eléctrico.

Mod. M-94-GT3

- Longitud: 1.750 mm.
- Altura máx.: 1.005 mm.
- Altura mín.: 750 mm.
- Ancho sin guías: 600 mm.
- Conexión a red: 220 V 70 W
- Inclinación respaldo: 75º
- Posición Trendelemburg: 30º
- Movimientos regulados por 3 motores eléctricos.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

MESA DE QUIROFANO

Mod. M-94-Q4
Mesa para cirugía compuesta por 5 planos articulados entre sí, con base de columna elevable mediante actuadores eléctricos de mando por cable.

- Longitud: 1.900 mm.
- Ancho sin guías: 480 mm.
- Altura máx.: 1.030 mm.
- Altura mín.: 730 mm.
- Inclinación respaldo: -20º a 75º
- Posición Trendelemburg: 45º
- Posición anti-Tren: 20º
- Inclinación lateral (izquierda-derecha): -20º a 20º

Mobiliario clínico en general

Carros de parada cardíaca
Carros de curas
Mesas auxiliares
Vitrinas clínicas
Negatoscopios
Mesas de reconocimiento
Taburetes
Mesa Mayo
Básculas y Tallímetros

Iluminación

Lámpara provista de una bombilla halógena especial de 12 V/20 W que garantiza una luz clara y blanca para toda clase de reconocimientos y con los accesorios para fijación mural. También se puede suministrar con soporte rodable o fijación por mordaza.

LÁMPARA DE EXAMEN HALÓGENA HEINE

LÁMPARA DE EXAMEN DE LUZ FRÍA HEINE HKL

El proyector para fibra óptica HK 7000 tiene una lámpara halógena especial de alta potencia de 150W de larga duración. Para exploraciones con las que se desee más luz, se puede aumentar la intensidad de luz momentáneamente hasta un 40% con un interruptor de aumento.

LÁMPARA DE QUIRÓFANO TRUMPF HELION

TRUMPF HELION S+
Lámpara de exploración, examen y pequeñas intervenciones de cirugía ambulatoria, con pie rodable o para instalación en pared o techo.

TRUMPF HELION M+
Lámpara de operaciones de gran luminosidad para intervenciones de grado medio, cirugía ambulatoria y salas de cirugía menor, con pie rodable o para instalación en pared o techo.

TRUMPF HELION L+
Lámpara de operaciones de gran luminosidad para intervenciones quirúrgicas en las que no se requiere un satélite adicional. Para instalación en techo.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

LÁMPARA DE QUIRÓFANO LED TRUMPF TRULIGHT

TRUMPF TruLight 1000
Lámpara de operaciones tecnología LED para examen y pequeñas intervenciones. Incluye base placa de anclaje a techo, embellecedor de techo, brazo de extensión, brazo de resorte y cuerpo de lámpara. Nula emisión de radiación IR. Cuerpo de lámpara con ejes de giro en tres dimensiones, manejo confortable sin esfuerzo. 6 fuentes de luz individuales compuestas por diodos LED con lente incorporada. Empuñadura esterilizable. Pantalla de protección resistente a impactos y productos de limpieza.

TRUMPF TruLight 3300
Lámpara de operaciones tecnología LED, diseño extraplano de apenas 6 cm. de grosor, asas laterales para mayor comodidad de uso, matriz multilente formada por 60 diodos LED de alta eficacia, máximo rendimiento lumínico y bajo consumo energético. Panel de control mediante teclado de membrana situado en el lateral del cuerpo de lámpara, incluye interruptor ON/OFF y regulador de intensidad de luz.

Equipos de electromedicina

ECÓGRAFOS GENERAL ELECTRIC (P.O.E.)

Línea LOGIQ
Sistemas digitales de ecografía de altas prestaciones para aplicaciones múltiples. Utiliza la arquitectura TruScan, con TruAccess, Smart Scan y Comfort Scan que ofrece una calidad de imagen extraordinaria, gestión total de datos, optimización automática y un diseño ergonómico e intuitivo.

Línea VOLUSON
Sistemas líderes de imagen.
Diseñados para aplicaciones de obstetricia, ginecología, neonatal, abdominal, vascular, urología, transcraneal y partes blandas.

- 4D en tiempo real.
- 3D Multiplanar display.
- “Glass-body” rendering (visualización transparente de información tisular y vasos).
- 3D Power Doppler.
- Optimización automática 3D CFM.

ENDOSCOPIA

Disponemos de una completa gama de equipos de endoscopia con especial atención a los equipos de uso ginecológico como Laparoscopios, Histeroscopios, Insufladores, Irrigadores, Fuentes de luz, Cámaras de video CCD, Extractores de humo, Trócares e Instrumental de histeroscopia y laparoscopia ginecológica.

El sistema de cámara portátil DIGICAM, ha revolucionado el mundo del diagnóstico por endoscopia

digiCAM
clever endoscopy and documentation set

COLPOSCOPIOS

Video colposcopio LEISEGANG 3MV-USB LED
Consiste en un colposcopio Standard 1D con cámara de vídeo digital integrada.

Sistema de fijación:

- Estativo upright con 5 ruedas –dos de ellas bloqueables-está indicado para su desplazamiento por la consulta o la clínica.
- Estativo articulado adaptable a mesa ginecológica.
- Soporte pesado con ruedas para estativo articulado.

Especificaciones de la videocámara:

- Píxeles activos: 765x582
- Resolución: = 460 TVL
- Modo balance blanco: AWB (auto white balance) modo fijo seleccionable vía software
- Velocidad de obturación: 1/50 a 1/100.000
- Control de iris: CCD Iris por defecto

Colposcopio LEISEGANG 1 LIGHT LED
Para el reconocimiento rutinario, con aumento fijo de 15x, filtro verde para observación de vasos, alumbrado LED de intensidad regulable sin escalones. Compensación de ametropía de +7 a –7 dioptrías. Puede acoplársele un adaptador fotográfico. No requiere ningún ajuste especial.

Sistema de fijación:

- Estativo upright con 5 ruedas –dos de ellas bloqueables- está indicado para su desplazamiento por la consulta o la clínica.
- Estativo articulado adaptable a mesa ginecológica.
- Soporte pesado con ruedas para estativo articulado.

Colposcopio LEISEGANG 1 LED
Para el reconocimiento rutinario, con 15 aumentos, filtro verde, alumbrado LED de intensidad regulable sin escalones. Compensación de ametropía de +7 a –7 dioptrías. Puede acoplársele un adaptador fotográfico. No requiere ningún ajuste especial.

Sistema de fijación:

- Estativo upright con 5 ruedas –dos de ellas bloqueables-está indicado para su desplazamiento por la consulta o la clínica.
- Estativo articulado adaptable a mesa ginecológica.
- Soporte pesado con ruedas para estativo articulado.

MICROSCOPIOS

Microscopio OLYMPUS Cx31
Microscopio con revólver cuádruple, platina mecánica con mando ergonómico a la derecha, pinza sujeta muestras para dos portas, condensador de Abbe CX-CD A.N. 1,25 con diafragma de apertura, iluminación halógena 6 V 30 W, diafragma de campo, filtro azul 32,5C-2, aceite inmersión 8 cc. y llave de Allen. Cabezal binocular 30° con distancia interpupilar regulable 48-75 mm. y ajuste dióptrico en el ocular izquierdo, oculares 10x FN.20.

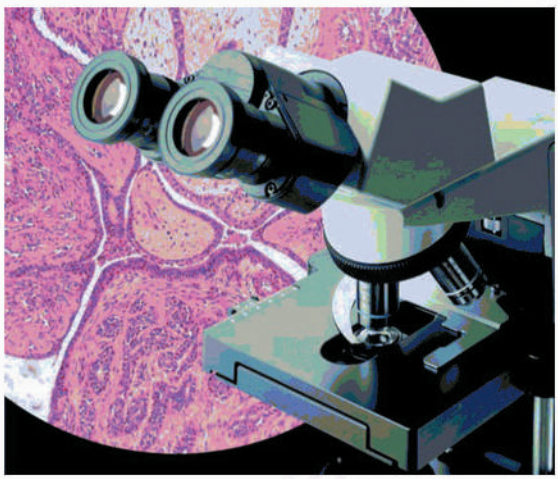

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Microscopio OLYMPUS Cx22

Microscopio óptico ideal para docencia debido a su fácil manejo y a la fijación mediante tornillos de elementos móviles como oculares y condensador que evitan el deterioro prematuro o la pérdida de componentes. Iluminación LED incorporada, condensador Abbe NA 1,25 fijado por tornillo al estativo, ajustable en altura y diafragma de apertura con indicador de posición para objetivo 4x, 10x, 40x y 100x, y filtro compensación luz día incorporado. Sistema de enfoque coaxial ajustable en tensión y con bloqueador de enfoque para protección del objetivo y la muestra. Platina cuadrada con carro móvil y cableado interno libre de mantenimiento. Revólver cuádruple con fácil accesibilidad a los objetivos para su limpieza y mantenimiento. Cabezal binocular giratorio 360ª con inclinación ergonómica a 30ª y del tipo Siedentoph lo que mantiene la corrección dióptrica de los oculares independientemente a la distancia interpupilar, regulable de 48-75 mm. Oculares de alto punto focal lo que garantiza una comodidad extrema en los trabajos de rutina, fijados al cabezal por tornillos internos, tratamiento anti-moho y gran campo de observación FN.20. Opcional con luz halógena.

MONITORES DE CONSTANTES VITALES

Monitor WA Serie 300

Monitor de signos vitales para pequeñas intervenciones y salas de reanimación.

Características:

- Presión arterial no invasiva (PNI)
- Termómetro SureTemp Plus. Tiempos de medición:
  - 4 segundos - oral
  - 10 segundos - axilar pediátrico
  - 15 segundos - axilar adultos
  - 10 segundos - rectal
- Pulsioximetría (SaO2)
- Impresora opcional.

Monitor WA Spot

Monitor de signos vitales para pequeñas intervenciones y salas de reanimación.

Características:

- Presión arterial no invasiva (PNI)
- Pulso y presión arterial media (PAM)

Opcional:

- Termómetro SureTemp
- Pulsioximetría (SaO2)

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y ENTREGA A MERCADO NACIONAL

1. Generalidades:
- Salvo que se hubiere pactado algo en contra de manera expresa y por escrito, todos los compradores aceptan el carácter vinculante de las presentes Condiciones Generales de venta y entrega.
- Se entenderá que las presentes Condiciones Generales de venta y entrega han sido aceptadas por los compradores a más tardar en el momento de la recepción de la mercancía.

2. Condiciones de pago:
- Los precios son los vigentes según la tarifa aplicada en cada momento y las condiciones de pago las que se detallan en la factura según los plazos pactados e indicados al pie de la misma.

3. Reclamaciones y garantías:
- En el momento de la entrega, el comprador tiene la obligación de verificar si la mercancía entregada cumple con lo solicitado a efectos de realizar cualquier reclamación.
- Las devoluciones únicamente serán aceptadas si éstas se realizan con prontitud y como máximo dentro de los 10 días naturales siguientes a la recepción de la mercancía o de forma previa a cualquier tratamiento de la mercancía cuando se haya remitido una muestra de la misma, siempre que la mercancía haya sido remitida en perfecto estado, por lo que podría ser rehusada su aceptación, y siendo el coste del envío de la devolución siempre a cargo del cliente salvo pacto expreso.
- En caso de que la devolución fuera admitida, EUROGINE, S.L. se reserva el derecho de efectuar el cargo de los costes producidos por la revisión de la mercancía, así como los gastos de manipulación.
- Aquellas devoluciones originadas en caso de defecto por responsabilidad de EUROGINE, S.L. serán abonadas al precio de compra o reemplazadas en su totalidad a criterio de EUROGINE, S.L., siendo los portes a cargo de ésta siempre y cuando se realicen por la agencia indicada.
- El plazo máximo de la responsabilidad por defectos de la mercancía se limita a un año.
- Si la mercancía estuviere dañada o en mal estado por causas del transporte en el momento en que el comprador la recibiere, es de obligado cumplimiento que éste indique la salvedad que procediere en el albarán de entrega del transportista, a fin de poder realizar cualquier reclamación o sustitución de la mencionada mercancía.

4. Fuerza Mayor:
- En caso de fuerza mayor, EUROGINE, S.L. quedará liberada de la obligación de suministro durante el tiempo que dure la causa de fuerza mayor.
- Lo mismo ocurrirá en caso de circunstancias imprevisibles y no atribuibles a EUROGINE, S.L. que pudieren retrasar o impedir el suministro por parte de los proveedores de ésta. En este caso, EUROGINE, S.L. se reserva el derecho de cancelar parcial o completamente dicho suministro sin tener la obligación de indemnizar al comprador.

5. Reserva de dominio:
- Todos los productos entregados al comprador siguen perteneciendo a la propiedad de EUROGINE, S.L. con todos los derechos mientras el comprador no haya abonado todos los créditos a favor EUROGINE, S.L. en relación con la contraprestación por productos entregados.

6. Disposiciones varias:
- Las modificaciones o adiciones al contrato se realizarán por escrito.
- Las comunicaciones por correo electrónico o por fax serán suficientes para el cumplimiento de dicha forma escrita. El comprador es el único responsable de la utilización de los productos de EUROGINE, S.L.

7. Lugar de cumplimiento y fuero jurisdiccional:
- El lugar de cumplimiento y fuero jurisdiccional exclusivo son los del domicilio social de EUROGINE, S.L. La legislación autonómica y la estatal que estén vigentes, serán las de aplicación.

8. Divisibilidad:
- En caso de que cualquier disposición de las presentes Condiciones Generales no tuviera o dejara de tener validez o efecto, las restantes disposiciones de las mismas seguirán teniendo validez.
- En tal caso, las partes contratantes convienen en sustituir la disposición no válida por una válida que se corresponda más estrechamente con el propósito económico.

contracepción-ginecología
euro gine

iber mdc
equipamiento clínico

Distribuido por Suministros Clínicos LANAU
Teléfono: 976 125 700
E-mail: m.gracia@sclanau.com
Web: www.sclanau.com